

NYE AKER

MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT – SÆRMØTE SKOPVASK



Utvalgte rom Endoskopvask

Gjennomgang av inventar og utstyr

Romnr. - Romnavn

13.04.036 - Sluse intern (desinfeksjon endoskop)

13.04.037 - Desinfeksjon, endoskop uren

13.04.038 - Desinfeksjon, endoskop ren

Tilbakemelding etter møte 02 Pulje 1

O Sterilsentral og sentral enhet for endoskopvask - NSA

Ren sone

13.04.038 - Desinfeksjon, endoskop ren


Det legges til rette for en PC-plass.

Det må være et pakkebord i ren sone. Gjennomstikkskap til uren sone for retur.

Til avklaring:

- Ønskes PC plassert ved pakkebord som vist? Alternativt kan en pc-plass plasseres innerst i rommet der det er vist 2 stk høyskap. Hvilken plassering vil gi best arbeidsflyt?
- Størrelse på gjennomstikkskap?
- Behov for høyskap?

Foreslått løsning:

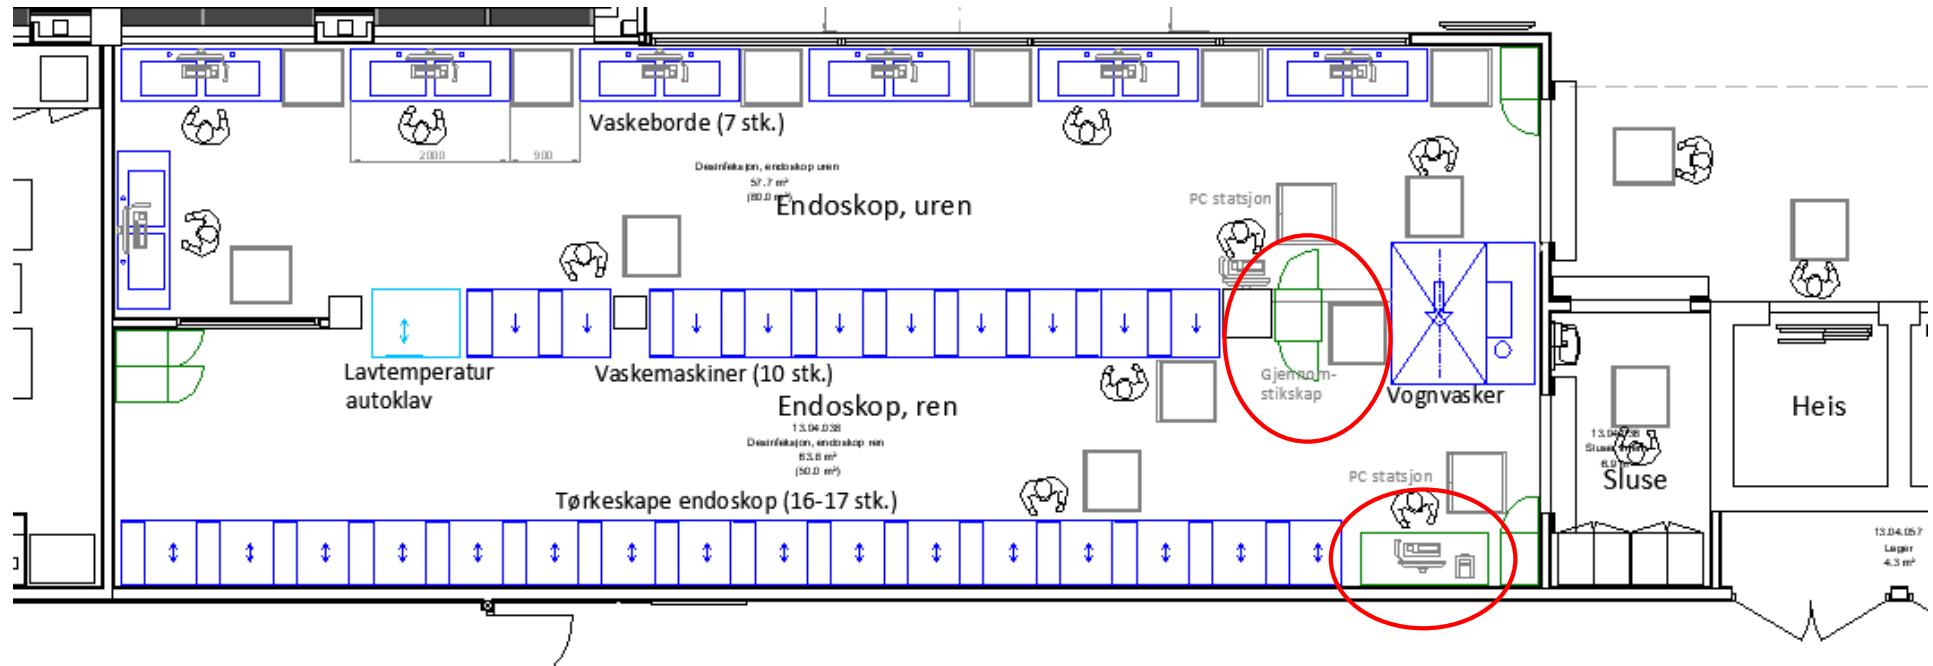

Uren side

13.04.037 - Desinfeksjon, endoskop uren

Skap for forbruksmateriell

Håndvask, evt. en i hver ende av rommet.


Det legges til rette for en PC-plass

Det er lagt inn en gjennomgående vaskemaskin for vogner. Vasking av bakker kan gjøres i vognvaskemaskinen med egne innsatser.

Til avklaring:

- Er det tilstrekkelig med 1 stk standard kasse-bakkeskap 400x600 mm?
- Plassering av håndvasker må avklares med hensyn på flyt og bekostning av annet utstyr.
- Plassbehov for egne innsatser til vasking av bakker?

Foreslått løsning:

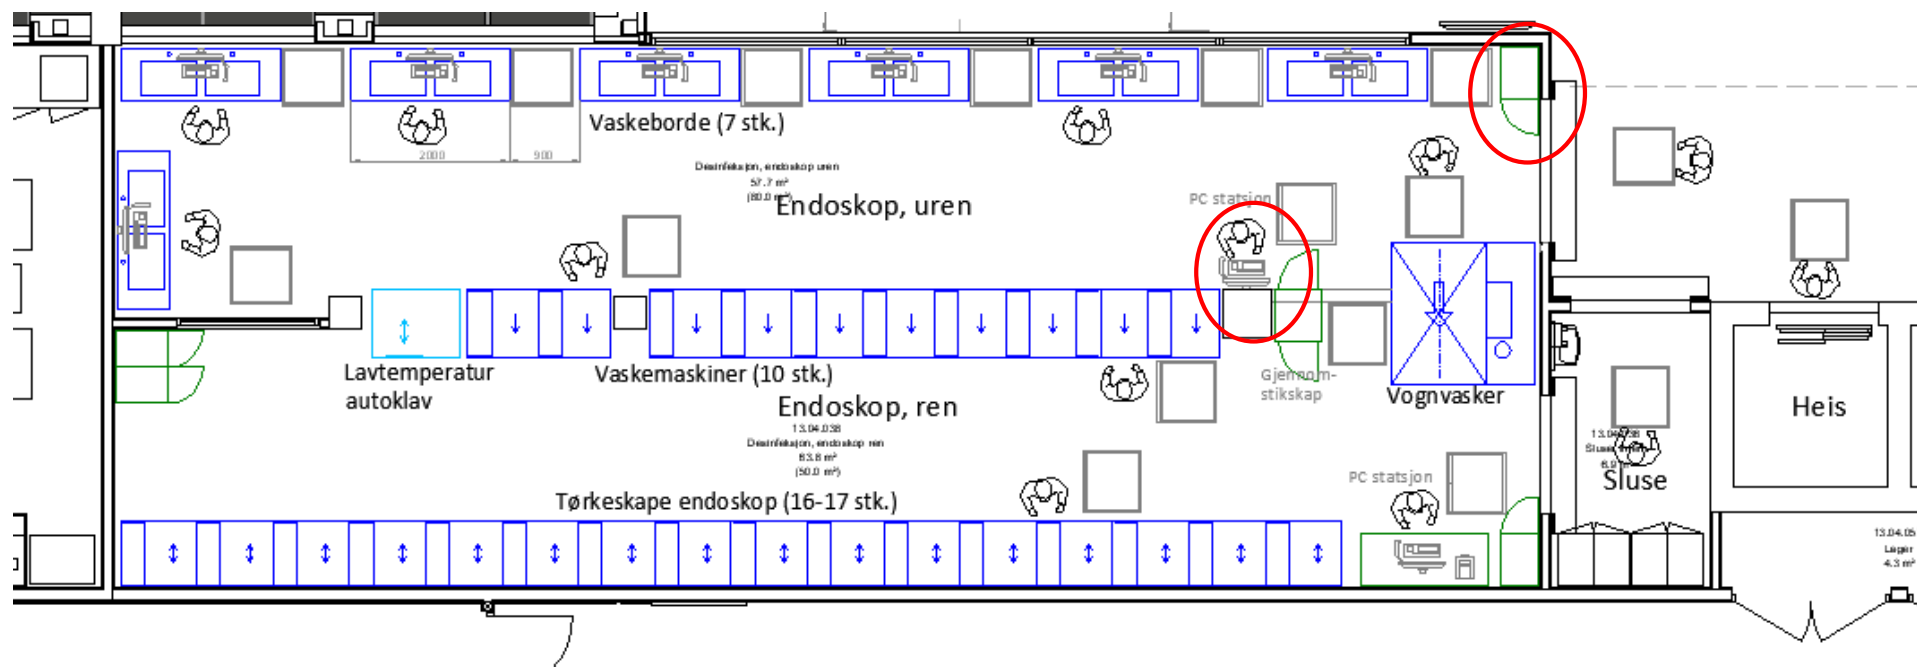

Koffert til transport av skop


Plass for koffert for transport til service enten på ren side eller lett tilgjengelig i nærheten. ARK foreslår en plassering.

Til avklaring:

- Plass for 1 eller flere koffertene? Hva slags dimensjoner har de aktuelle koffertene?
- Kan foreslått lagerløsning benyttes for oppbevaring av koffert til endoskop?

Foreslått løsning:

Det er etablert et lager (rom 13.04.057) med brede dører bak heisene. Tilkomst fra korridor/ kulvert. Lageret kan ha dype hyller for oppbevaring av emballasje, transportkasser og koffert etc.

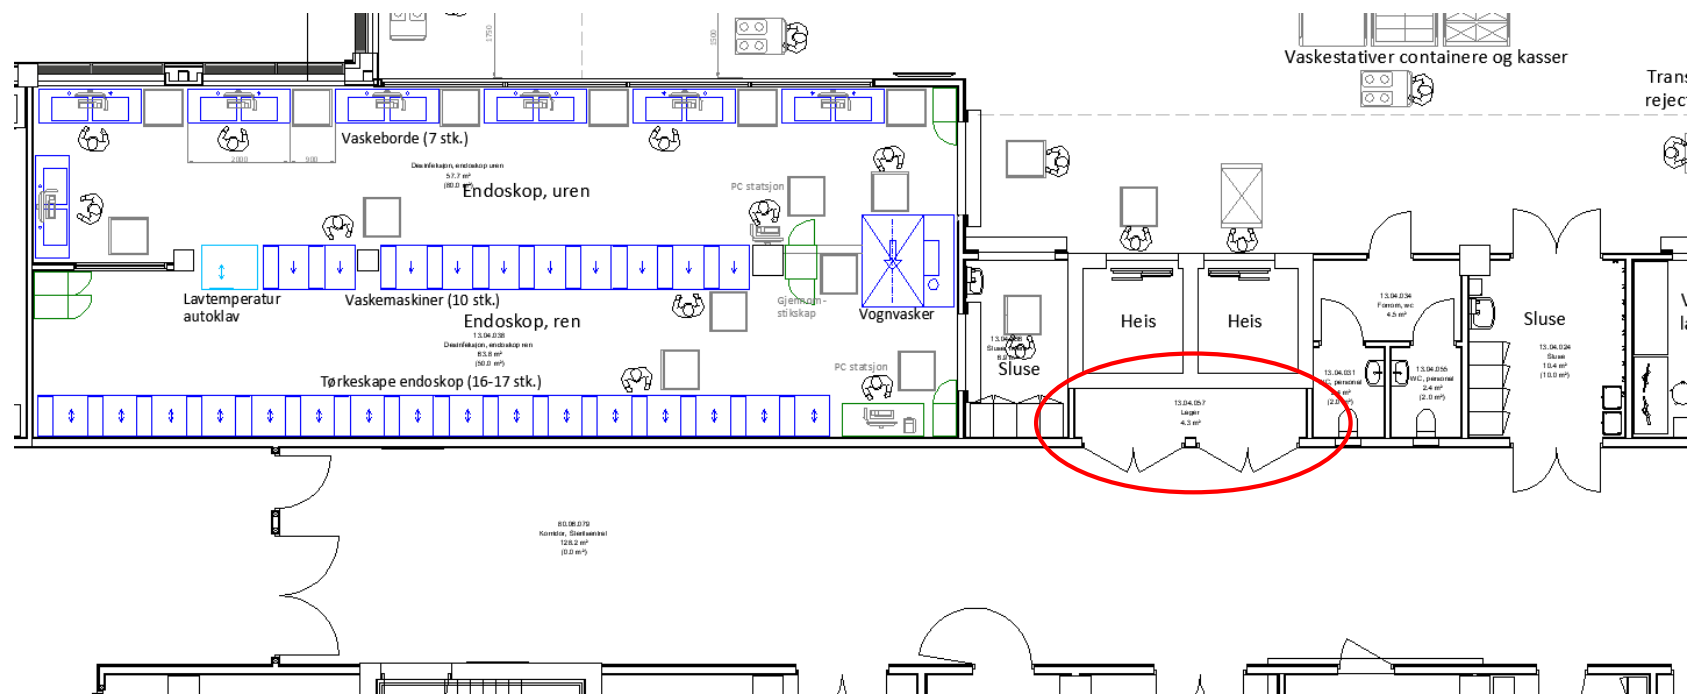


Lavtemperaturautoklav

Det vurderes om det er mulig å plassere en lavtemperaturautoklav i ren sone.

Til avklaring:

- Dimensjoner på maskin?
- Er foreslått plassering ok?

Foreslått løsning:

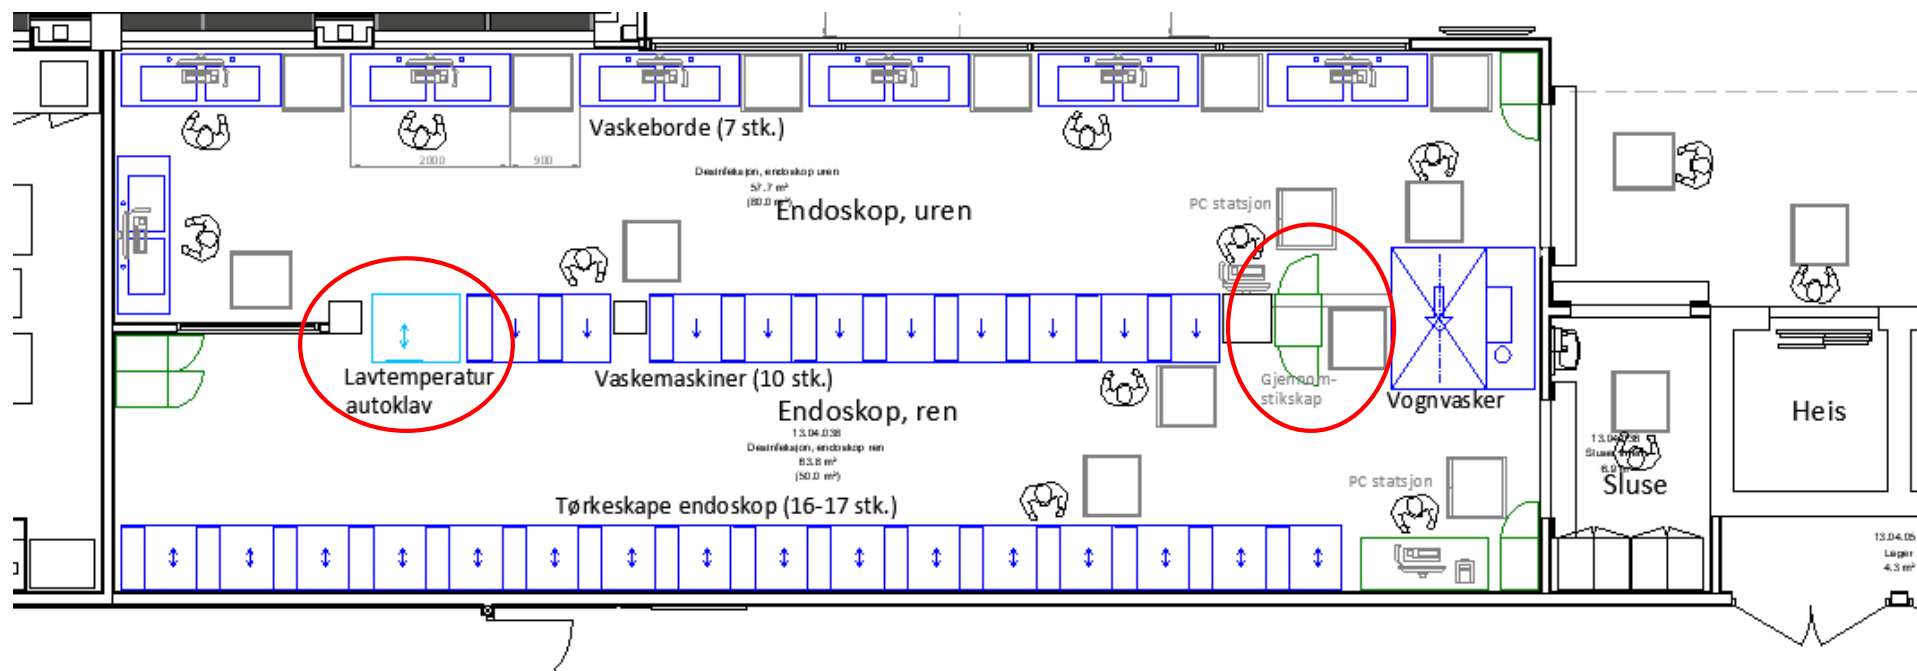


Sluse

Ikke behov for uren sluse, kun sluse til ren sone. Slusen skal ha mulighet for oppbevaring av tøy og forbruksmateriell.

Til avklaring:

- Ønsket innredning av sluse?
- Ønsket bredde for rullporter?

Foreslått løsning:

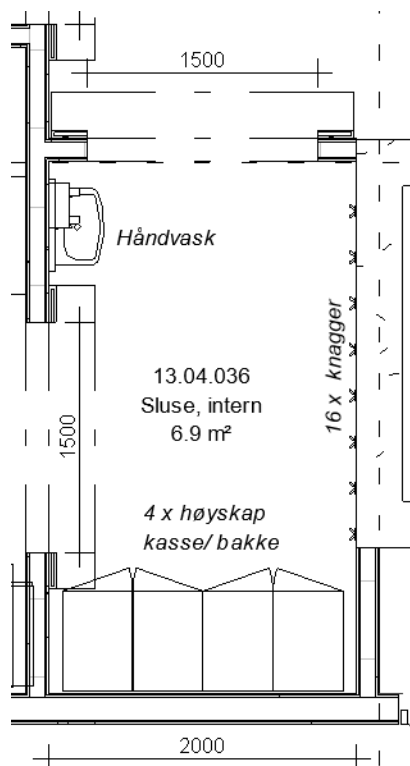

Vaskeplass

Hver vaskeplass skal ha to kummer - anbefaling fra smittevern. Hylle pr plass for forbruksmateriell. Såpe til hver plass. Hanskestativ.

Det ønskes PC og strekkodeleser ved hver vaskeplass.

Til avklaring:

- Ønskede dimensjoner på vaskebord og vaskekummer?
- Plassering av PC og skanner?
- Antall bord, 6 eller 7? Ikke optimale plassforhold ved bordet i hjørnet ved endeveggen
- Er det mulig med en kombinasjon av noen doble kummer og noen enkle? F.eks 2 mindre vaskebord innerst langs kortveggen for å frigjøre litt plass ved inngangsparti?

Foreslått løsning (med 7 vaskebord, bredde 2 m):

